COLOQUICK

A BETTER FUTURE

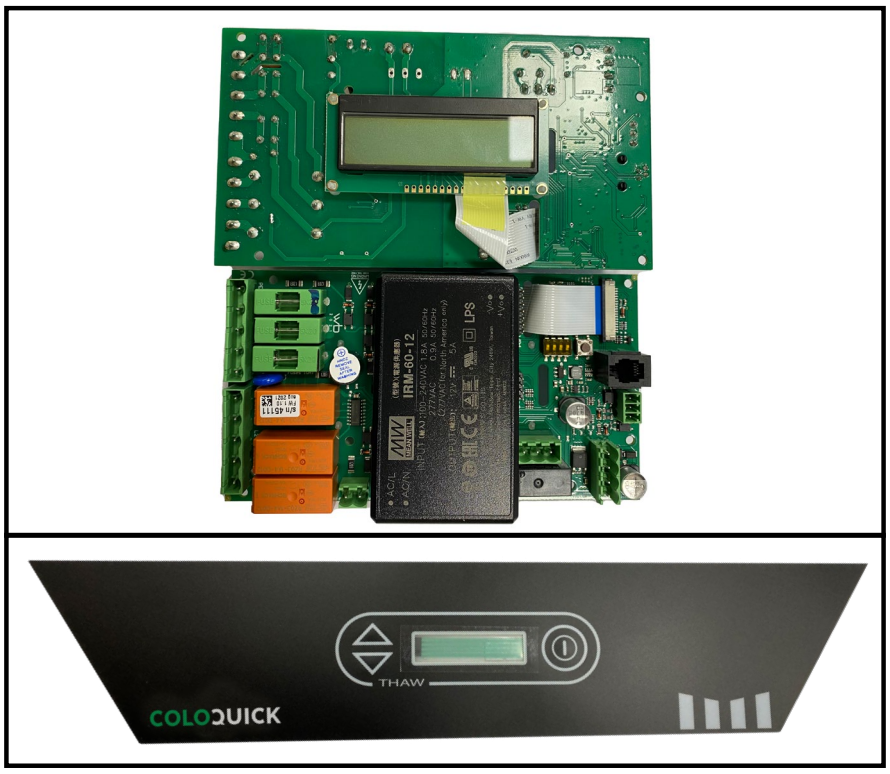

MANUAL DE SUSTITUCIÓN DE PANEL Y/O UNIDAD DE CONTROL

ES

Índice

Herramientas necesarias 2
Procedimiento y precauciones de seguridad 2
Guía de procedimiento 3

Procedimiento y precauciones de seguridad

Este manual es una guía para reemplazar el panel y/o la unidad de control.

- Los niños y las mascotas no deben dejarse sin supervisión con el ColoQuick. Tenga especial cuidado cuando la cubierta y/o la puerta de servicio estén abiertas.
- Existe riesgo de descarga eléctrica cuando la puerta de servicio está abierta. Sólo debe ser abierto por personal autorizado y capacitado por Calvex A/S.
- Este procedimiento sólo debe ser realizado por personal autorizado y capacitado por Calvex A/S.

Herramientas necesarias

Cinta adhesiva, herramientas y alcohol isopropílico.

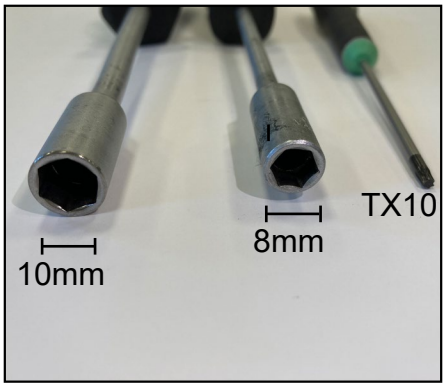

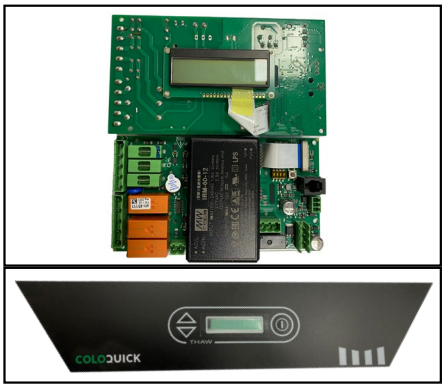

Panel y unidad de control.

Guía de procedimiento

1. Coloque la unidad DESCONGELADORA a una altura adecuada para facilitar el acceso. Abra la tapa para desactivar el sensor de la tapa.
Asegúrese de que la máquina esté apagada.

2. Retire las tuercas para desbloquear la puerta de servicio.
¡CUIDADOSO! ¡Peligro de descarga eléctrica al abrirlo! ¡APAGUE LA UNIDAD!

3. Abra la puerta de servicio para acceder a la caja negra.

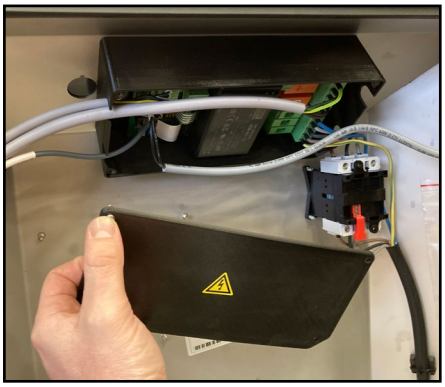

4. Quite los cuatro tornillos y quite la cubierta negra de la caja.
¡CUIDADOSO! ¡Riesgo de shock eléctrico!

5. ¡No toque los componentes eléctricos cuando la máquina esté encendida!

6. Desconecte los conectores. Primero los dos conectores verdes del lado derecho de la unidad de control.

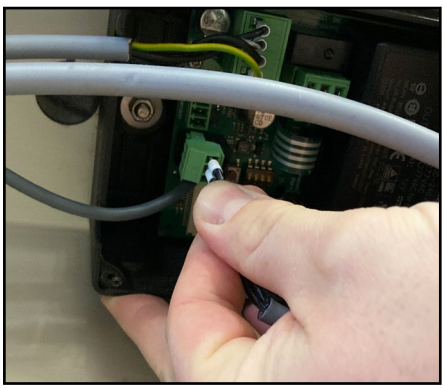

7. Desconecte el conector pequeño en la esquina izquierda de la unidad de control.

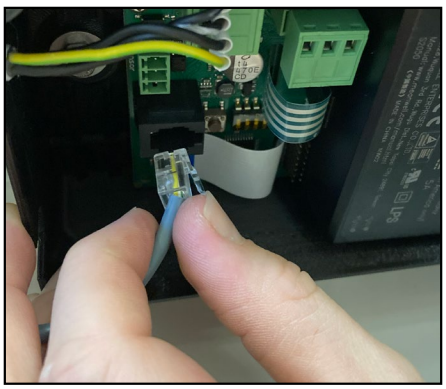

8. Desconecte el conector transparente en la esquina izquierda de la unidad de control.

9. Retire el conector verde grande en la esquina superior izquierda de la unidad de control.

Guía de procedimiento

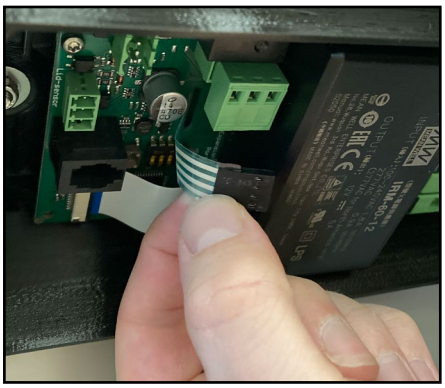

10. Desconecte el conector del monitor de la unidad de control.

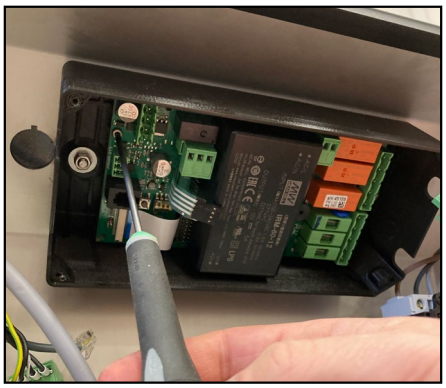

11. Retire los seis tornillos que aseguran la unidad de control a la caja negra.

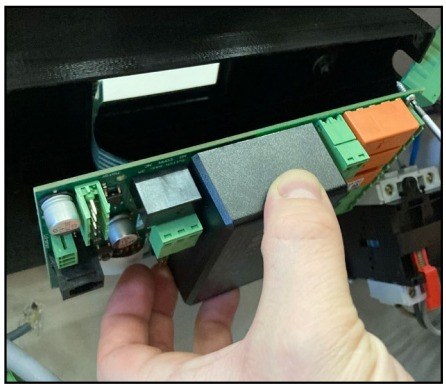

12. Retire la unidad de control de la caja. Maneje siempre la unidad de control con cuidado.

13. Retire el panel de la puerta de servicio. Empezar a retirar por una esquina.

14. Limpie y retire el pegamento restante del puerto de servicio con una toalla y alcohol isopropílico.

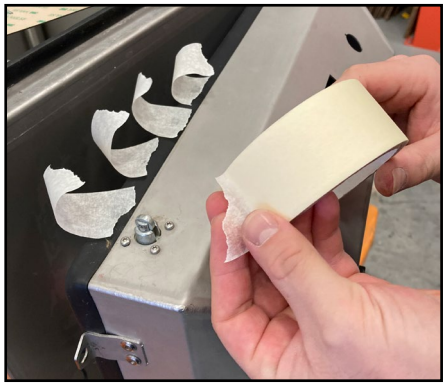

15. Prepare cuatro pedazos de cinta adhesiva.
Utilice la cinta adhesiva, que es fácil de quitar y no deja marcas.

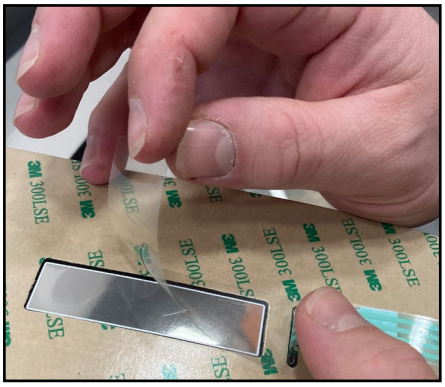

16. Retire el protector del monitor del nuevo panel.

17. Sostenga el monitor en su lugar y asegúrelo al puerto de servicio con los pedazos de cinta.

18. Coloca cinta adhesiva en un lado y en el medio solamente. Asegúrese de que el monitor esté en el lugar correcto antes de continuar con el siguiente paso.

Guía de procedimiento

19. Retire lentamente la cubierta de la esquina del monitor y dóblela hacia atrás y hacia abajo.

20. Sostenga la tapa hacia abajo y pegue la esquina a la superficie.

21. Presione el bisel uniformemente en el puerto de servicio.

22. Retire la cubierta debajo del tablero. **No levante demasiado el panel, esto podría romperlo.** Asegúrese de que el conector del monitor esté dentro del orificio.

23. Presione el panel uniformemente en el puerto de servicio mientras lo mantiene alineado.

24. Asegúrese de que los botones se puedan presionar.

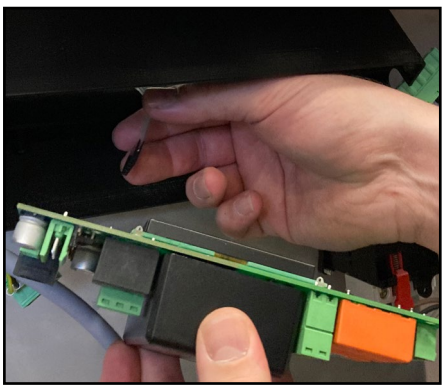

25. Si la unidad es nueva, retire el protector del monitor. Deslice el conector del monitor a través del orificio alineado con la unidad de control.

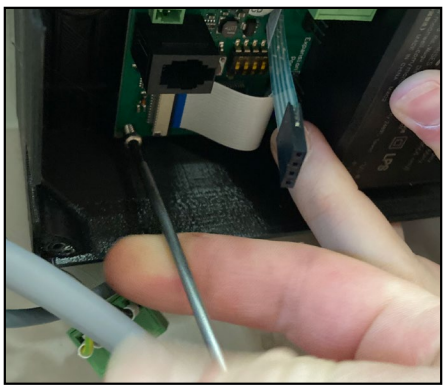

26. Asegure la unidad de control en su lugar con los seis tornillos.

27. Conecte el monitor a la unidad de control.

Guía de procedimiento

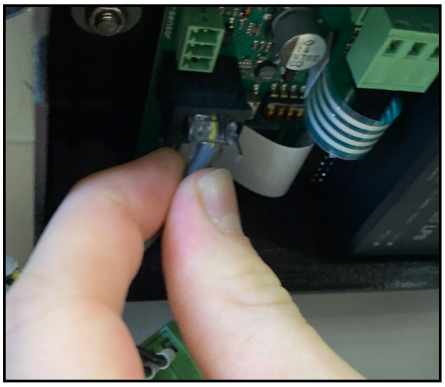

28. Conecte el conector transparente.

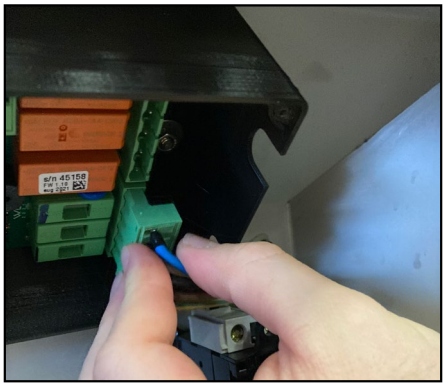

29. Enchufe el conector verde en la esquina inferior derecha.

30. Encienda la máquina. **¡CUIDADOSO! ¡Peligro de descarga eléctrica cuando la puerta de servicio está abierta!**

31. Asegúrese de que el monitor esté centrado. La imagen de arriba muestra un monitor aplicado debajo del punto correcto.

32. Ajuste la caja negra aflojando las dos tuercas ubicadas a cada lado de la caja negra y mueva la caja a la ubicación deseada.

33. Asegúrese de que el área del monitor esté visible.

34. Apague la máquina.

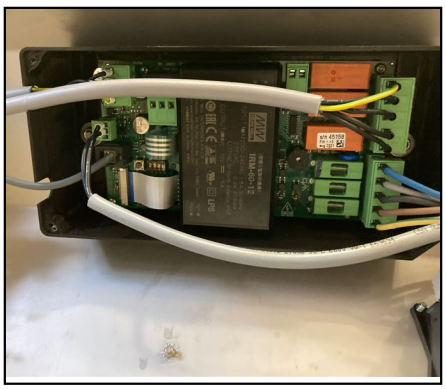

35. Conectar el resto de conectores para que la centralita sea idéntica a la configuración inicial.

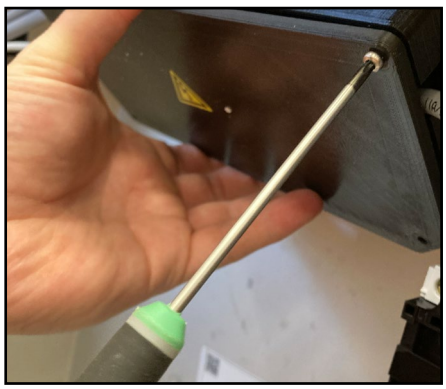

36. Cierra la caja negra con la tapa y cuatro tornillos.

Guía de procedimiento

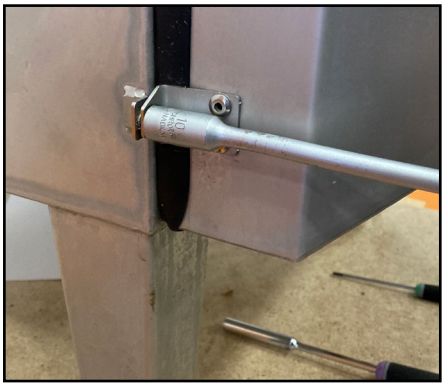

37. Cierre la puerta de servicio con tuercas.

38. La unidad de descongelación ahora está lista para usar.

Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos:

ColoQuick
Teléfono: +45 9753 7333
Email: info@ColoQuick.com

ES

GN-TFC0002-ES